

建筑涂料透水性试验漏斗


说明：建筑内外墙底漆或复层建筑涂料均须测试其涂膜的透水性，标格达提供专用于测试这两种产品的系列透水性试验漏斗：

BGD 1357---透水性试验漏斗（内外墙底漆用）：符合GB/T 9756《合成树脂乳液墙面涂料》和JG/T 210《建筑内外墙用底漆》标准，容积为 $95 \pm 5\text{ml}$ ，上部玻璃管带有4ml刻度，最小分度值为0.1ml，磨砂底盘直径为65mm~66mm；

BGD 1359---透水性试验漏斗（未涂漆试板用）：符合GB/T 9756《合成树脂乳液墙面涂料》标准，容积为 $140 \pm 5\text{ml}$ ，上部玻璃管带有20ml刻度，最小分度值为0.2ml，磨砂底盘直径为65mm~66mm；

BGD 1358---透水试验漏斗（复层建筑涂料用）：符合GB/T 9779《复层建筑涂料》标准，由直径75mm玻璃颈漏斗和分度值为0.05ml的5ml移液管组成。

试验时将未涂漆试板或涂有样品且完全干燥后的试板置于水平状态，把透水试验漏斗放在试板的中部，用不吸水的密封材料密封试板和漏斗四周缝隙，确保水不会从缝隙渗出，带密封材料干燥后，将试验用水导入玻璃管内，直至试管的0刻度线处，确认容器中无气泡后再次调整试管的0刻度，将玻璃管顶端用锡箔纸遮盖包住，然后在规定的试验条件下静置24小时，以液面下降毫升数来评价该试板或该样品的透水性大小。

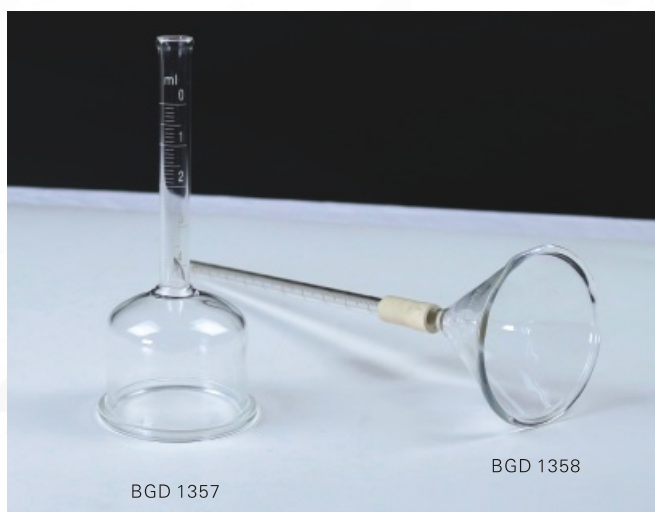

订购信息

BGD 1357---透水性试验漏斗（内外墙底漆用）

BGD 1358---透水性试验漏斗（复层建筑涂料用）

BGD 1359---透水性试验漏斗（未涂漆试板用）